

検査ニュース Vol.4 No.1


ご挨拶

平素より佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・検査センターの業務にご協力及びご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

今回は、前号でお知らせした抗酸菌検査フローチャートについて、診療報酬算定上の留意事項をご案内致します。これに伴い、フロー図を一部修正しました。

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター
専務理事 志田正典

●抗酸菌検査フローチャート

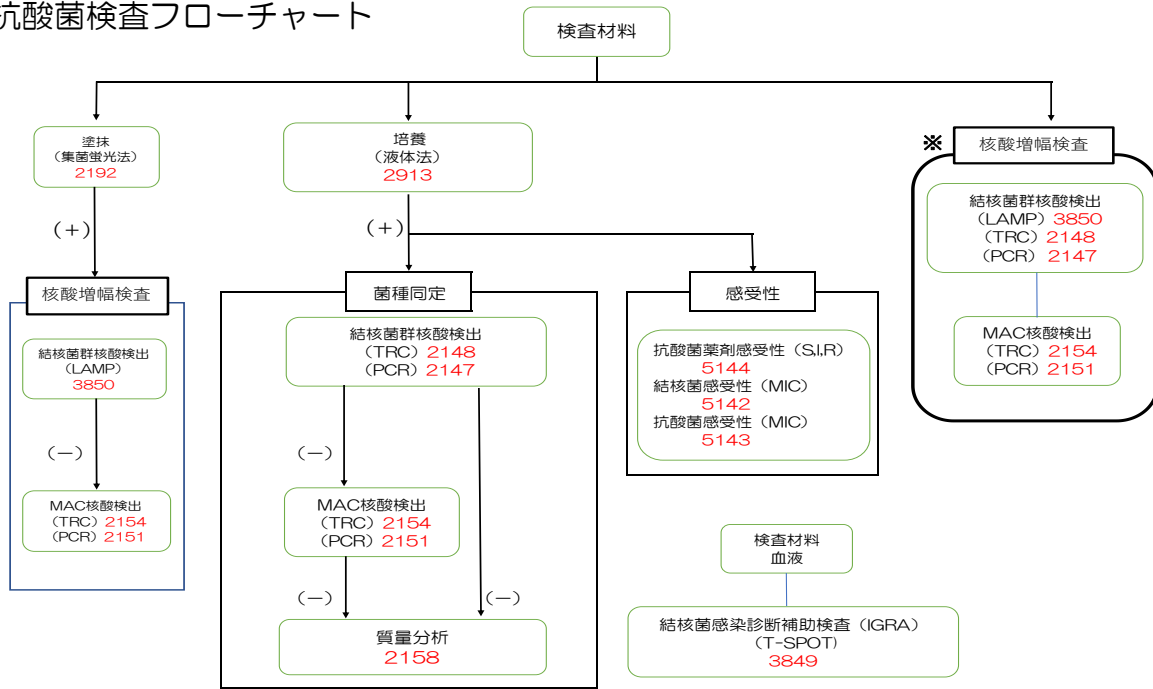

【補足】診療報酬算定上の留意事項

- 結核菌群核酸検出と、非結核菌群(MAC)核酸検出の同時検査は不適となります。(図※)
- 医学的判断で同時検査は不適になることがあります(以下2点)
 - 結核菌群核酸検出(LAMP, TRC, PCR)と結核菌感染診断補助診断(IGRA)
 - 結核菌塗抹・培養と結核菌感染診断補助診断(IGRA)

●お詫びと訂正

前号でご案内した「※2 抗酸菌培養」の検査方法に誤りがございました。お詫びして、訂正させていただきます。

誤			正		
※2 抗酸菌培養			※2 抗酸菌培養		
項目コード No.	現 5131	新 2913	項目コード No.	現 5131	新 2913
検査項目	抗酸菌培養(小川法)	抗酸菌培養(液体法)	検査項目	抗酸菌培養(小川法)	抗酸菌培養(液体法)
検査方法	2%小川培地	酵素感受性蛍光センサー法	検査方法	2%小川培地	酵素感受性蛍光センサー法